ICS 75.080
E 30

2008-08-25 发布

单位为毫米

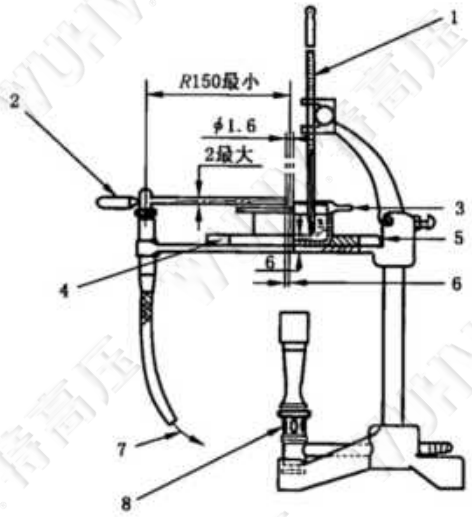
1
R150最小
2
φ1.6
2最大
3
5
6
4
6
7
8

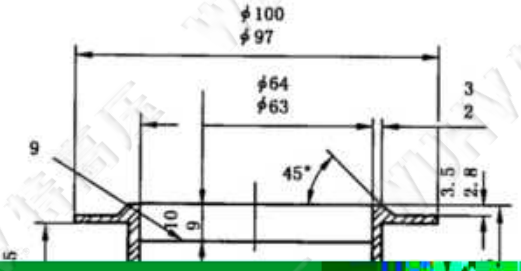
φ100
φ97
φ64
φ63
3
2
9
45°
3.5
2.8
10
9

φ159
φ146
φ70.5
φ69.5
φ56
φ55
7
6

单位为毫米

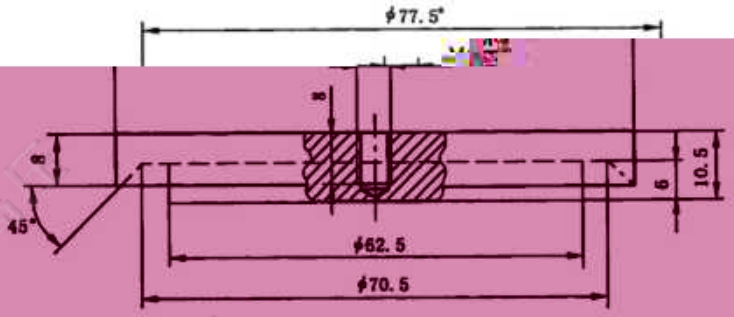

B.4.1.1 单次试验：对于CRM或SWS

式中：

x——单次试验结果；

x_0——CRM标定值或SWS的给定值；

[illegible]

次试验；$\bar{x}$次结果的平均值与CRM标定值或SWS的给定

B.4.1.2 多次试验：对于CRM或SWS的$\bar{x}$值之差，应满足式(B.2)的要求。

[illegible]

[illegible]使用CRM，要上述步骤。如果试验结果满足上[illegible]

WUHV特高压

附 录 C
（资料性附录）

本标准与 ISO 2592:2000 章条编号对照

表 C.1 给出了本标准章条编号与 ISO 2592:2000