


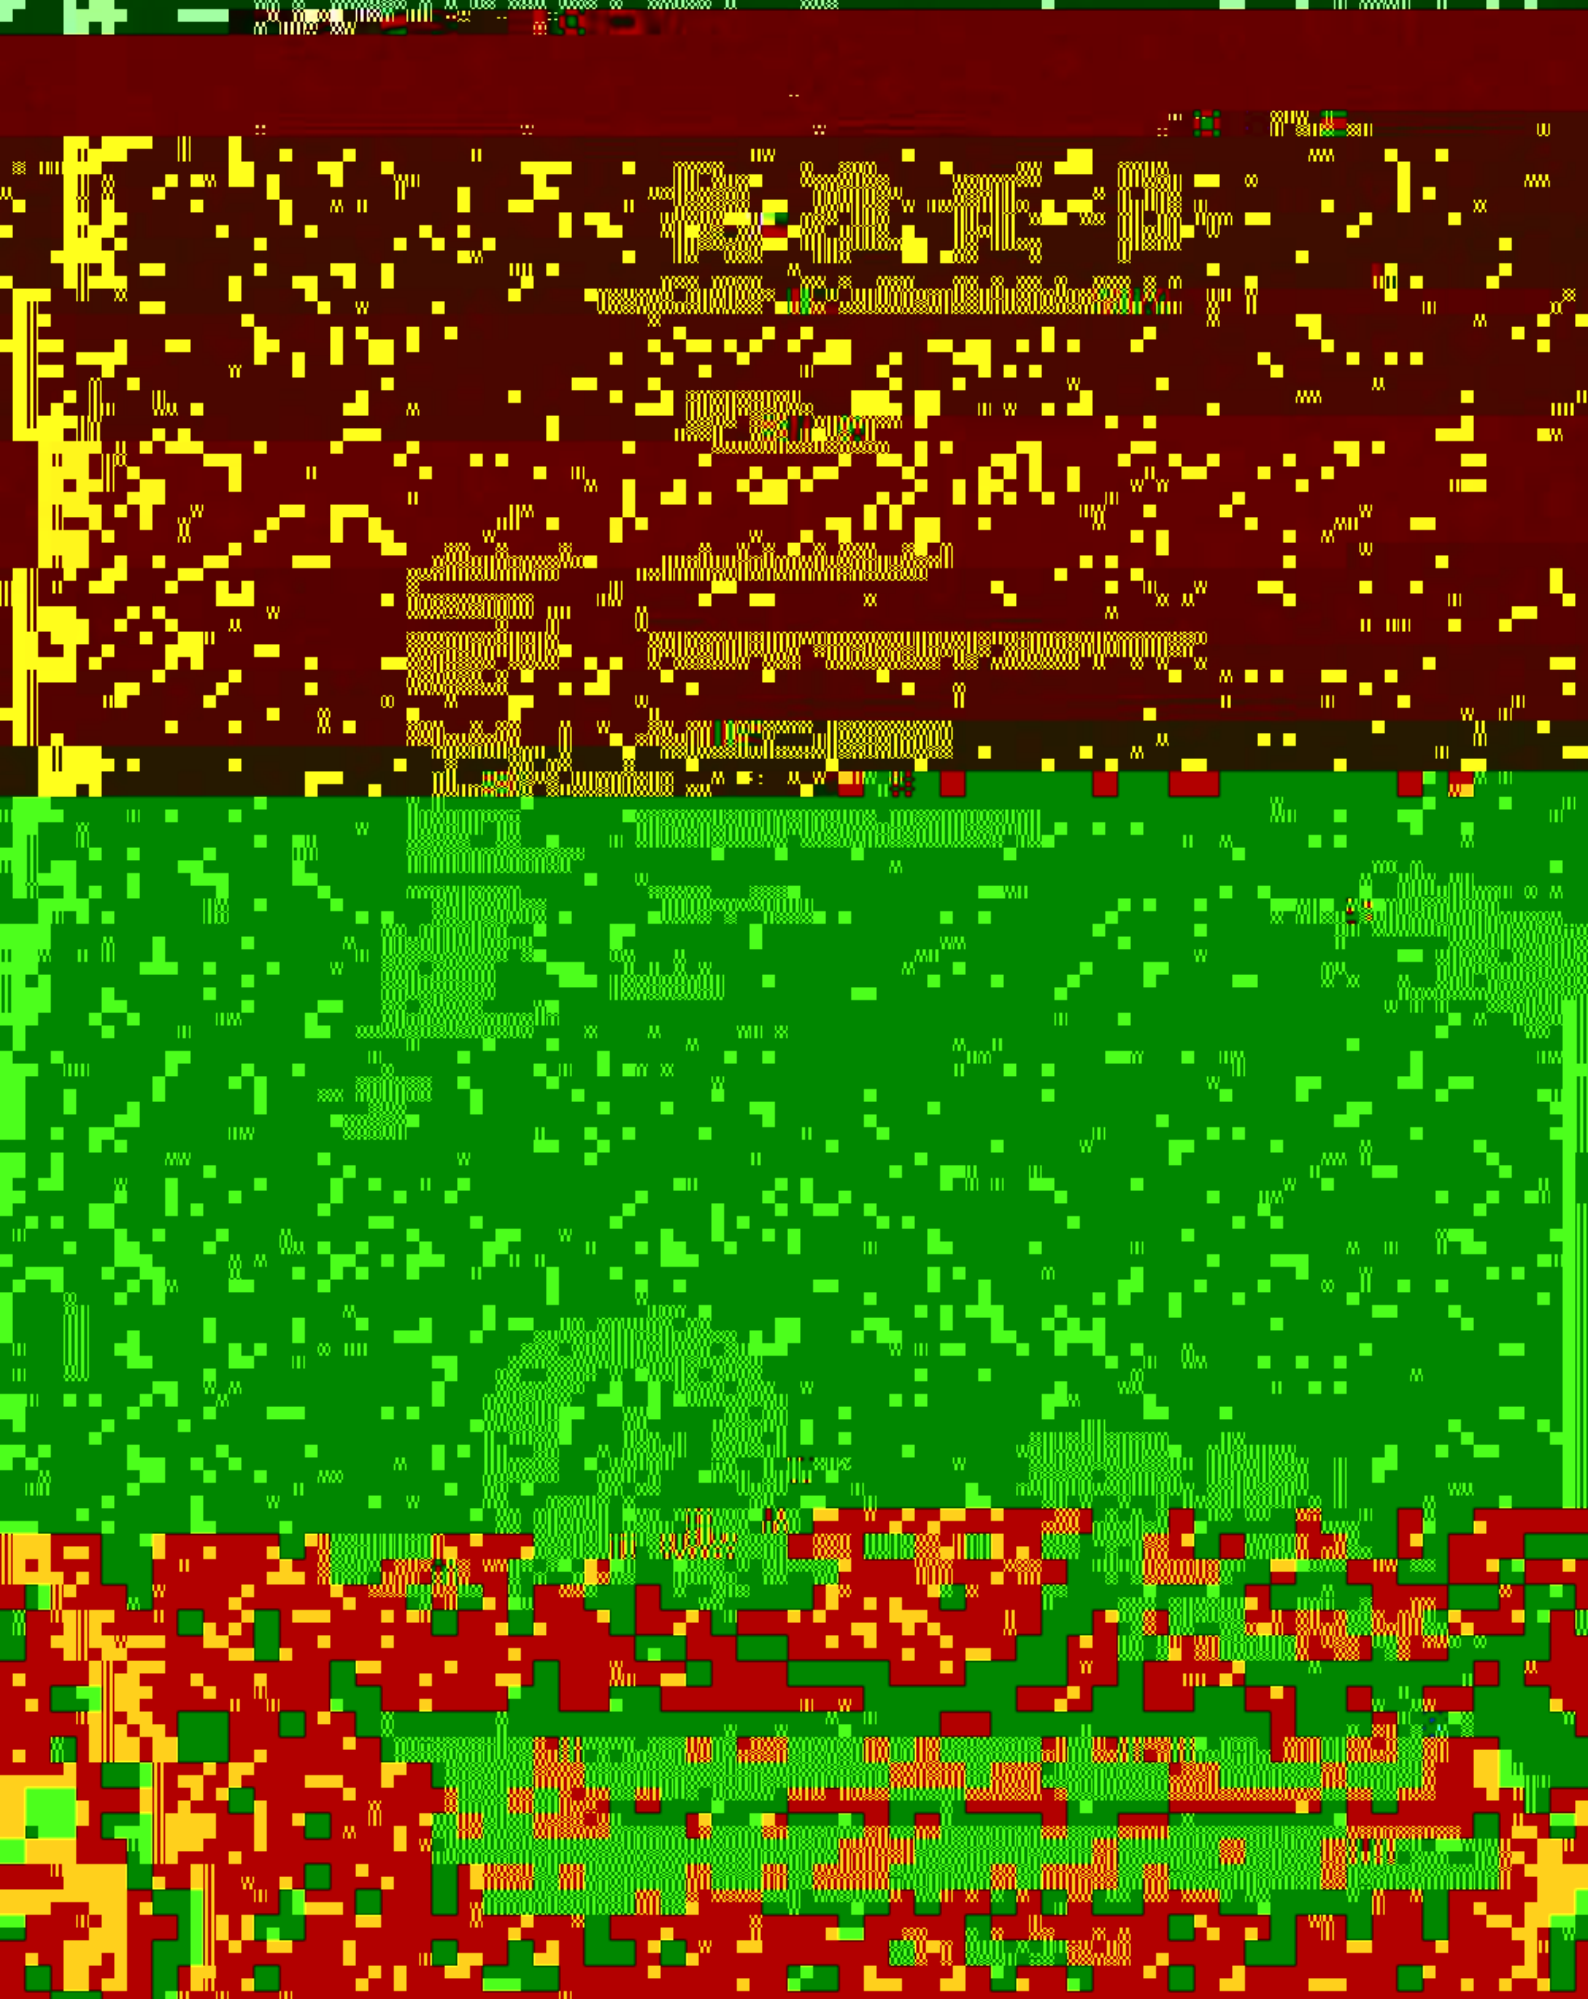

本院是政府计量

第 2 页

22.3°C

ture

—

相对湿度: 63 %

R.H.

地点: 光谷基地B132

Place

其它: —

Others

原始记录编号: —

Report No.

温度:

Temper

气压:

Pressure

本校/

It's Ef

未经/

结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

ect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

院许可, 不得部分复制本证书。

校准数据/结果

Data Results of Calibration

一、外观检查: 正常

二、电阻测量

标准值 (Ω)	实测值 (Ω)			测量不确定度: $U(\Omega)$
	A	B	C	
0.1	0.11	0.11	0.11	0.05
1	1.01	1.01	1.01	0.05
10	10.25	10.00	10.30	0.12

以下空白

术研究院
年