


湖北省计量测试技术研究院

Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山中路二号 邮编 (Post Code): 430223
网址 (Web site): <http://www.hbmet.com> 电话 (Tel): 027-81925136

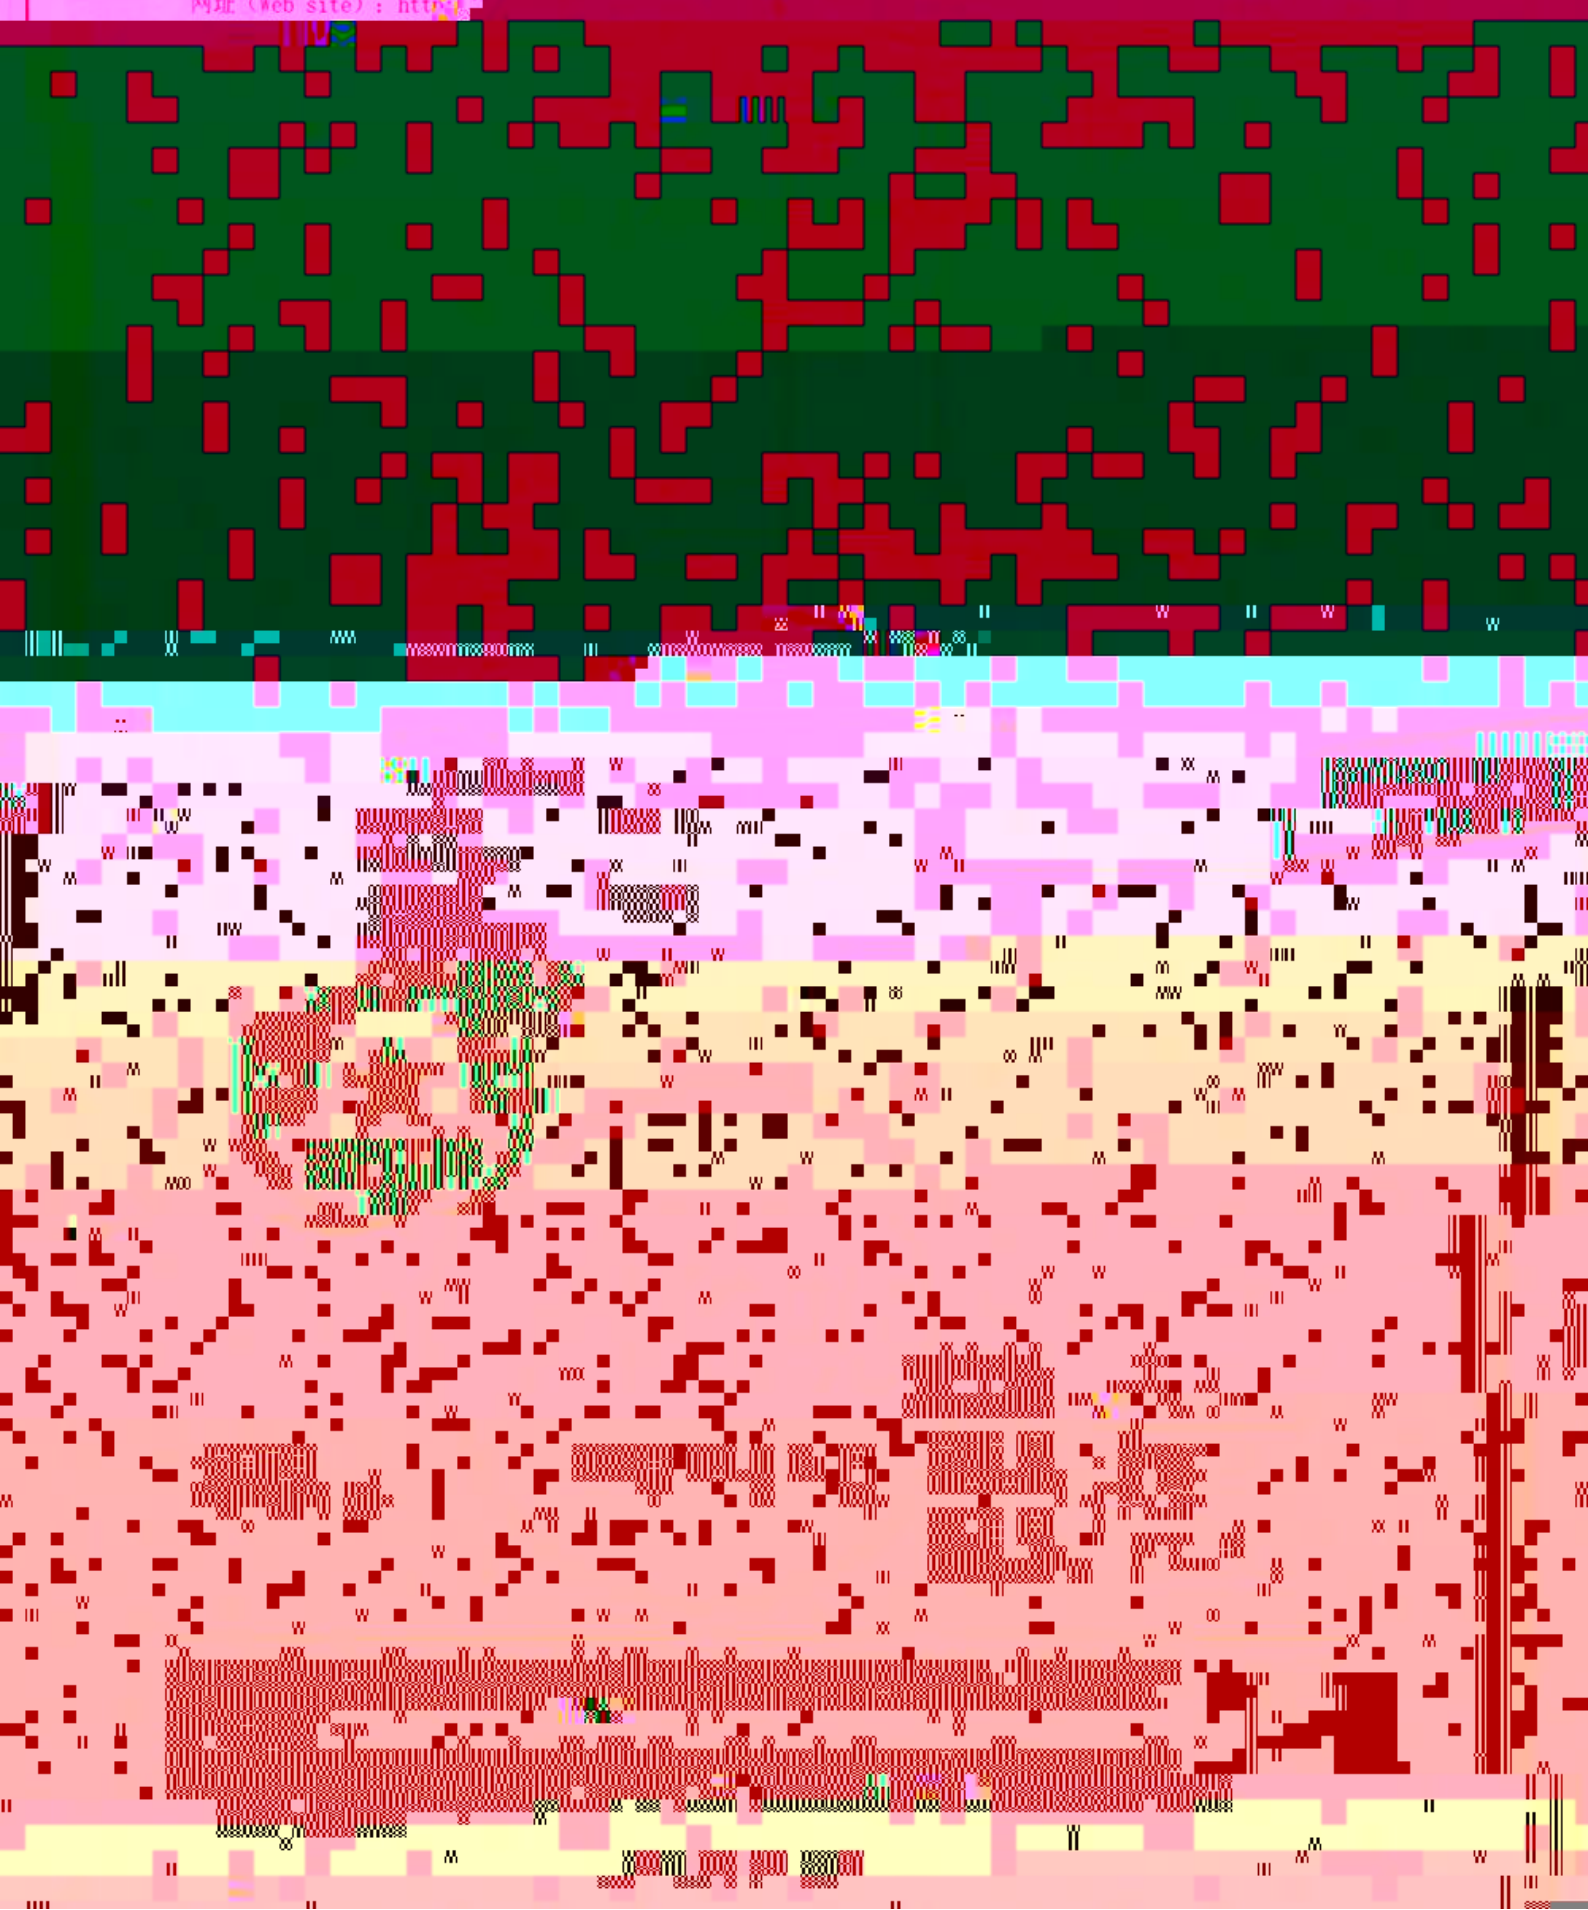

- 本院是政府计量行政管理部门依法设立的法定计量检定机构。

This laboratory is a legal metrological verification institution established by the government metrological administrative department according to law.

技术依据(名称、代号)

Reference documents for calibration (name, code)

参照: JJG 490—2002 脉冲信号发生器

参照: 技术说明书

- 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards used

校准数据/结果

Data/Results of Calibration

一 外观及工作可靠性检查

项目	检查结果
外观	正常
附件	黑色铁皮附件箱子一个(内有:仪器配套磁性线圈,测试线等)
通电检查	工作正常
仪器连接	连接仪器配套磁性线圈

二 仪器“磁场电压”的“绿”、“黄”端子间输出信号测试

仪器控制		输出测量结果
管型	磁场电压指示值 (V)	电压 (V)
00	1658	1548
02	1658	1553
04	1658	1559
06	1657	1566

电压测量的测量不确定度: $U_{rel}=1.3\%$; $k=2$

以下空白